Gebruikshandleiding

Defibcom Mini



LEES DEZE HANDLEIDING NAUWKEURIG

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Medizon B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van deze handleiding.

WAARSCHUWING

Dit symbool geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan.

Heeft u vragen over het veilig gebruik of zijn instructies onduidelijk? Neem dan contact op met Medizon B.V. of met uw distributeur.

Houd de behuizing te alle tijde gesloten. In verband met gevaar voor elektrische schokken.

INHOUD VERPAKKING

De Defibcom Mini wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- Defibcom Mini
- Handleiding
- QR-code

INSTALLATIEVOORWAARDEN

- Plaats de Defibcom Mini in een stopcontact op maximaal 5 meter afstand van de AED in dezelfde ruimte.

- Gebruik een AED die wordt ondersteund door de Defibcom Mini (Defibtech Lifeline View voorzien van softwareversie 2.9 of hoger en zorg dat de communicatiemodule in het menu aan staat.)

- Check of er voldoende 4G-Dekking aanwezig is.

- Zorg ervoor dat de AED in een omgeving geplaatst wordt die qua temperatuur en luchtvochtigheid aan de gestelde eisen in de handleiding van de AED voldoet.


PRODUCTOMSCHRIJVING

De Defibcom Mini is een apparaat dat de status van de AED continu bewaakt. De Defibcom Mini controleert of de AED correct functioneert en inzetbaar is, zoals de elektroden (pads), de accu en andere essentiële componenten.

De Defibcom Mini maakt gebruik van een LTE-M-verbinding die wordt beveiligd via een VPN. Hierdoor kan het apparaat continu de status van de AED monitoren en deze informatie doorgeven, zodat eventuele storingen of onderhoudsbehoeften tijdig worden gesignaleerd.

De Defibcom Mini bewaakt continu de status van de AED door de resultaten van de automatische zelftests te controleren. Wanneer een storing wordt gedetecteerd, ontvangt de beheerder direct een e-mailmelding. De AED doet een dagelijkse zelftest en detecteert eventuele problemen en meld deze aan de beheerder.

Ook wanneer de Defibcom Mini geen zelftestsignaal meer ontvangt, wordt de beheerder automatisch geïnformeerd. Dit kan erop wijzen dat de AED is verwijderd of dat de Defibcom Mini geen verbinding meer heeft met de stroomvoorziening.

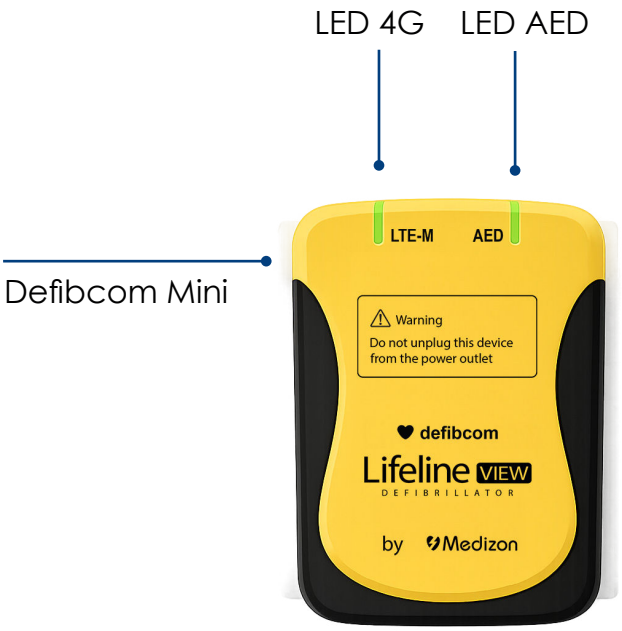

EERSTE GEBRUIK

In gebruikname van de Defibcom Mini.

1. Haal de Defibcom Mini uit de verpakking.

2. Scan de QR-code op de verpakking. Deze verwijst u naar de registratiepagina.




3. Op de registratiepagina vult u de gevraagde gegevens in. Druk op verzenden voordat u de pagina afsluit. Hiermee bepaalt u zelf naar welk e-mailadres de berichten worden verzonden. Bij voorkeur een algemeen e-mailadres.

4. Plaats de Defibcom Mini in het stopcontact.



5. De Defibcom Mini maakt verbinding met het netwerk. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de linker (LTE-M led) groen oplichten. Dit kan enkele minuten duren.

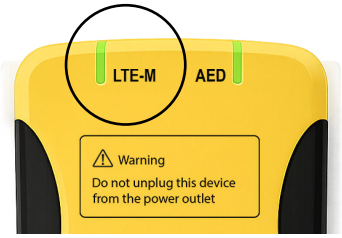

6. Haal de AED uit de verpakking.

7. Maak de AED gereed volgens de bijgeleverde handleiding (installeer de batterijen en elektroden).

8. Zet de communicatiemodule in het menu van de AED aan. Dit werkt als volgt:

8.1. Druk op de middelste knop.



8.2. Controleer of softwareversie V2.9 of hoger is geïnstalleerd.



8.3. Scrol met de pijlen aan de rechter zijde naar AED opties.



8.4. Druk op de middelste knop om naar het optiemenu te gaan.

8.5. Als u in het menu AED-opties bent, selecteer dan Status transmissie ingeschakeld.



8.6. Ga terug naar het hoofdmenu.

9. De AED en de Defibcom Mini maken verbinding met elkaar. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, licht ook de rechterled groen op.



10. U ontvangt op het door u ingestelde e-mailadres een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen en dat uw AED verbonden is met de Defibcom Mini.

LEDS

De Defibcom Mini heeft twee leds. De led aan de linkerkant (LTE-M) geeft aan of de Defibcom Mini een goede LTE-M-verbinding heeft. Deze led kan twee kleuren hebben; groen en rood.

Hieronder worden de kleuren van de LTE-M-led uitgelegd:

Groen
Defibcom Mini is verbonden met het netwerk.

Knipperend groen
Defibcom Mini is aan het verbinden.

Rood
De Defibcom Mini ondervindt een probleem en kan op deze locatie geen verbinding met het netwerk maken.

De led aan de rechterkant geeft de status van de AED weer. Deze led kan de volgende kleuren hebben: groen, blauw en rood.

Hieronder worden de kleuren van de AED led uitgelegd:

Groen
De AED is verbonden met de Defibcom Mini.

Blauw
Er is geen AED gevonden.

Rood
Één van de verbonden AED's heeft een probleem.





TROUBLESHOOTING

Hieronder vindt u een overzicht van veelvoorkomende storingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van de Defibcom Mini. Raadpleeg eerst de tabel om de mogelijke oorzaak van het probleem te achterhalen en de aanbevolen oplossing uit te voeren.

Wanneer het probleem aanhoudt of niet met de beschreven stappen kan worden opgelost, neem dan contact op met uw leverancier of de technische ondersteuning.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
LTE-M-led brandt rood	Herstart de Defibcom Mini door deze 1 minuut uit het stopcontact te halen en vervolgens weer terug te plaatsen.
	Blijft de led rood branden, zoek dan een andere locatie voor de Defibcom Mini.
	Blijft de led rood branden? Neem dan contact op met ons servicecenter.
AED-led is blauw	Controleer of de communicatie op de AED is ingeschakeld. Volg stap 8 van de procedure Eerste Gebruik
AED-led is rood	De houdbaarheidsdatum van de elektroden is verstreken.
	De batterij is (bijna) leeg
	AED geeft een foutmelding, neem contact op met ons servicecenter.

Houd de behuizing te alle tijde gesloten. In verband met gevaar voor elektrische schokken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hier vindt u gedetailleerde informatie over de afmetingen, het gewicht, de voeding, de omgevingscondities, de prestaties en andere technische kenmerken van het apparaat.

Voedingsspanning	220-240 V 50 Hz
Afmetingen	92 x 70 x 70 mm
Gewicht	106 gram
Temperatuurbereik	0 -50 °C
CE-certificering	

GARANTIE

De garantieperiode voor de Defibcom Mini bedraagt twee jaar na aanschafdatum.

BELANGRIJKE MEDEDELING

De Defibcom Mini is een hulpmiddel om uw Defibtech Lifeline View AED 24/7 te monitoren.

De officiële handleiding en gebruiksaanwijzingen van AED-fabrikant Defibtech LLC blijven van toepassing en dienen te allen tijde te worden opgevolgd

CONTACT

MEDIZON b.v.

Nijverheidsweg 2
9301 ZL Roden
The Netherlands

Telefoonnummer: +31 (0) 50 313 3096
Website: www.medizon.nl